



(57) Zusammenfassung: Die Orthese weist eine erste Schiene (2) und eine mit dieser gelenkig verbundene zweite Schiene (3) sowie mindestens eine Anschlageneinstellscheibe (14, 15) auf, um die Schwenkereichsanschläge in Extensions- und/oder Flexionsrichtung einzustellen. Es ist weiterhin eine Feststelleinrichtung zum Arretieren der mindestens einen Anschlageneinstellscheibe (14, 15) vorgesehen, die eine in Richtung der Schwenkachse (102) verschiebbare, relativ zur ersten Schiene (2) drehfest angeordnete Verriegelungsscheibe (16) aufweist. Die Verriegelungsscheibe (16) ist durch Verschieben zwischen einer die Anschlageneinstellscheibe (14, 15) radial übergreifenden Arretierstellung, in der die Verriegelungsscheibe (16) mit der Anschlageneinstellscheibe (14, 15) formschlüssig verriegelnd in Eingriff ist, und einer Freigabestellung bewegbar, in welcher die Verriegelungsscheibe (16) ausser Eingriff mit der Anschlageneinstellscheibe (14, 15) ist.

7/2005
10/505359**DT09 Rec'd PCT/PTO 19 AUG 2004****ORTHESE MIT EINSTELLBAREM BEWEGUNGSBEREICH**

5

Die Erfindung betrifft eine Orthese, beispielsweise eine
10 Ellbogenorthese, insbesondere zur Reduktion von Streck-
und/oder Beugedefiziten, gemäß dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1.

15 Insbesondere Gelenkkapseln und/oder Bindegewebe weisen
beispielsweise nach Bänderoperationen, Unfällen, Entzün-
dungen etc. häufig ein Streck- und/oder Beugedefizit auf.
Dies bedeutet, dass ein distales Körperglied, beispiels-
weise ein Unterarm, nicht mehr vollständig in seine norma-
le Extensions- oder Flexionslage bezüglich eines proxima-
20 len Körperglieds, beispielsweise eines Oberarms, gebracht
werden kann.

Orthesen dienen bekannterweise dazu, derartige Gelenke
insbesondere während der Bewegung zu führen. Weiterhin
25 soll die Orthese die Bewegung des Gelenkes in Extensions-
und/oder Flexionsrichtung derart begrenzen, dass Verlet-
zungen aufgrund übermäßiger Beanspruchung ausgeschlossen
werden.

Weiterhin werden zum Dehnen der Verkürzungen und Schrump-
fungen im Bereich des Gelenkes auch sogenannte Quengelvorr-
richtungen verwendet, d.h. Orthesen, die unter Federvorr-
spannung stehen und die Bewegung des Körpergliedes bis zur
5 gewünschten Extensions- bzw. Flexionsgrenze unterstützen.

Bei Orthesen müssen der Extensions- und Flexionsanschlag
innerhalb weiter Grenzen einstellbar sein, um den indivi-
duellen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden. Wei-
10 terhin ist eine einfache und schnelle Verstellmöglichkeit
der Schwenkbereichsgrenzen wünschenswert, um bei zunehmen-
der Mobilisierung des Gelenkes die Schwenkbereichsgrenzen
entsprechend einfach und schnell nachstellen zu können.

15 Bekannte, zum Quengeln verwendete Orthesen weisen zur Be-
grenzung des Schwenkbereichs Anschlagstifte auf, die in
verschiedene, um die Schwenkachse herum angeordnete Boh-
rungen eingesteckt werden können. Nachteilig ist hierbei
jedoch, dass das Verstellen des Extensions- und Flexions-
20 anschlags nur in groben Schritten, beispielsweise in 15°-
Schritten, möglich ist und die Schwenkbereichsgrenzen
daher häufig nicht genau genug eingestellt werden können.

Aus der US 5,873,847 ist eine Orthese bekannt, bei welcher
25 keine einsteckbaren Anschlagstifte, sondern zwei hinter-
einander angeordnete Anschlagseinstellscheiben zur Ein-
stellung der Schwenkbereichsgrenzen in Extensions- und
Flexionsrichtung verwendet werden. Zum Arretieren dieser
Anschlagseinstellscheiben ist eine Feststelleinrichtung in
30 der Form von zwei Druckplatten vorgesehen, die mittels
einer Schraube zusammengespannt werden können und dadurch
die dazwischen liegenden Anschlagseinstellscheiben ein-
klemmen. Nachteilig ist hierbei jedoch, dass zum Verstel-

len der Schwenkbereichsgrenzen ein Werkzeug erforderlich ist, um die Feststelleinrichtung lösen und wieder zusammenspannen zu können. Ein derartiges Werkzeug ist häufig gerade dann nicht zur Hand, wenn es benötigt wird. Weiterhin ist problematisch, dass die AnschlagEinstellscheiben relativ fest zusammengespannt werden müssen, um ein unerwünschtes Drehen der Anschläge auszuschließen. Dies erfordert einen gewissen Kraftaufwand beim Zuspinnen und Lösen der Feststelleinrichtung. Wird die Feststellschraube zu wenig festgedreht, kann es zu einer unerwünschten Verdrehung der AnschlagEinstellscheiben und damit zu einer Überdehnung der Muskeln, Bänder oder Sehnen kommen.

Der Erfindung liegt von daher die Aufgabe zugrunde, eine Orthese der eingangs genannten Art zu schaffen, mit der der Flexions- und/oder Extensionsanschlag auf einfache, schnelle, genaue und sichere Weise einstellbar und arretierbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den weiteren Ansprüchen beschrieben.

Bei der erfindungsgemäßen Orthese weist die Feststelleinrichtung eine in Richtung der Schwenkachse verschiebbare, relativ zur ersten Schiene drehfest angeordnete Verriegelungsscheibe auf. Diese Verriegelungsscheibe ist durch Verschieben zwischen einer die AnschlagEinstellscheibe radial übergreifenden Arretierstellung, in der die Verriegelungsscheibe mit der AnschlagEinstellscheibe formschlüssig verriegelnd in Eingriff ist, und einer Freigabestellung bewegbar, in welcher die Verriegelungsscheibe außer Eingriff mit der AnschlagEinstellscheibe ist.

Bei der erfindungsgemäßen Orthese wird somit die Verriegelung der mindestens einen AnschlagEinstellscheibe mittels einer axial verschiebbaren Verriegelungsscheibe vorgenommen, die in der Eingriffsstellung mit der AnschlagEinstellscheibe formschlüssig in Eingriff ist und in der
5 Freigabestellung mit der AnschlagEinstellscheibe nicht mehr in Kontakt ist. Hierbei bedeutet axial verschiebbar, dass die Verriegelungsscheibe in Richtung ihrer eigenen Drehachse und damit in Richtung der Schwenkachse des
10 Schienengelenkes verschiebbar ist.

Dadurch, dass die drehfest angeordnete Verriegelungsscheibe nicht mehr kraftschlüssig, sondern formschlüssig mit der AnschlagEinstellscheibe in Eingriff tritt, ist ein
15 unerwünschtes Verdrehen der AnschlagEinstellscheibe ausgeschlossen. Die Formschlussverbindung wird dabei zweckmäßigerweise dadurch geschaffen, dass die AnschlagEinstellscheibe eine Außenverzahnung und die Verriegelungsscheibe eine Innenverzahnung aufweist, die mit der Außenverzahnung
20 der AnschlagEinstellscheibe in und außer Kämmeingriff bringbar ist.

Die Verschiebung der Verriegelungsscheibe in Axialrichtung erfolgt zweckmäßigerweise mittels eines Drehteils, beispielsweise eines drehbaren Deckelteils, das ein Innengewinde aufweist und mit einem Außengewinde der Verriegelungsscheibe in Eingriff ist. Wird das Drehteil bewegt, bewegt sich die Verriegelungsscheibe spindelartig in Axialrichtung und kann damit in und außer Eingriff mit der
25 AnschlagEinstellscheibe gebracht werden. Befindet sich die Verriegelungsscheibe außer Eingriff mit der AnschlagEinstellscheibe, kann die AnschlagEinstellscheibe in die gewünschte Drehposition gebracht werden, bis der zugeordnete
30

Schwenkbereichsanschlag in der gewünschten Winkelstellung ist. Weiterhin wird durch entgegengesetztes Drehen des Drehteils die Verriegelungsscheibe wieder in Eingriff mit der Anschlageneinstellscheibe gebracht und diese damit arretiert.

Die Einstellung und Arretierung des Extensions- und/oder Flexionsanschlags ist damit auf sehr einfache, schnelle, genaue, sichere Weise und ohne Werkzeug möglich.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung der erfindungsgemäßen Orthese,

Figur 2: eine Explosionsdarstellung der Einzelteile der Orthese von Figur 1,

Figur 3: einen Längsschnitt durch das Schienengelenk der Orthese von Figur 1,

Figuren 4A und 4B : eine Ansicht schräg von oben bzw. unten eines Gehäuses,

Figur 5: ein Längsschnitt durch ein Drehteil,

Figur 6: eine Draufsicht auf eine Abdeckplatte,

Figuren 7A und 7B : eine Draufsicht bzw. Seitenansicht einer Verriegelungsscheibe,

Figur 8: eine perspektivische Darstellung einer

Anschlageinstellscheibe,

5 Figur 9: einen Längsschnitt durch das Gehäuse mit
eingesetztem Drehblock eines Totpunktver-
stellmechanismus,

10 Figur 10: eine Darstellung gemäß Figur 9, wobei zu-
sätzlich ein Arretierstift mit Druckfeder
und ein Exzenter Teil eingesetzt sind,

Figur 11: eine perspektivische Darstellung des Dreh-
blocks,

15 Figuren 12A einen Längsschnitt durch das Gehäuse mit
bis 12C : zwei Anschlaginstellscheiben und der
Feststelleinrichtung zum Arretieren der
Anschlaginstellscheiben, wobei sich die
Verriegelungsscheibe in der Verriegelungs-
20 position bzw. in zwei unterschiedlichen
Freigabepositionen befindet, und

25 Figur 13: eine perspektivische Darstellung eines
Abschnitts der zweiten Schiene mit mon-
tiertem Anschlagenelement.

30 Aus Figur 1 ist eine Orthese 1 zur Reduzierung von Streck-
und/oder Beugedefiziten von Ellbogengelenken mit einer
ersten, am Oberarm zu befestigenden Schiene 2 und einer
zweiten, am Unterarm zu befestigenden Schiene 3 ersicht-
lich, die mittels eines Schienengelenkes 4 gelenkig mit
der ersten Schiene 2 verbunden ist. Die Befestigung am
Ober- bzw. Unterarm erfolgt in bekannter Weise über Halb-
schalen 5, die an der ersten Schiene 2 bzw. zweiten Schie-

ne 3 angebracht sind, und über Bänder oder Riemen 6, die um den Ober- bzw. Unterarm geschlungen werden.

Die dargestellte Orthese ist dazu ausgelegt, nur einseitig an das betreffende Körpergelenk angelegt zu werden. Es ist jedoch auch denkbar, für ein Körpergelenk zwei derartige Orthesen vorzusehen, die dann auf verschiedenen Seiten des Gelenkes angebracht werden.

Weiterhin weist die dargestellte Orthese einen Federkraftmechanismus mit einem Federgehäuse 7, in dem eine in Figur 1 nicht sichtbare Druckfeder angeordnet ist, sowie einer Druckstange 8 auf. Über die Druckstange 8 wird die Kraft der Druckfeder derart von der ersten Schiene 2 auf die zweite Schiene 3 übertragen, dass eine Schwenkkraft zwischen den beiden Schienen 2, 3 sowohl in Extensions- als auch in Flexionsrichtung erzeugt wird. Es handelt sich somit um eine zweiseitig wirkende Quengelvorrichtung. Da ein derartiger Federkraftmechanismus bereits bekannt ist, wird dieser nur soweit erläutert, als dies zum Verständnis der Erfindung erforderlich ist.

Die dargestellte Orthese ermöglicht auf einfache und genaue Weise sowie ohne Werkzeug ein Verstellen der Schwenkbereichsgrenzen in Extensions- und Flexionsrichtung mittels zweier Einstellstifte 9, 10, sowie das einfache Einstellen eines Totpunktes, ab dem der Federkraftmechanismus in Flexions- bzw. Extensionsrichtung wirkt, durch Betätigen eines Drehknopfs 11.

Die einzelnen Komponenten dieser Orthese werden im Folgenden anhand von Figur 2 näher erläutert. Die Schwenkachse ist dort mit 102 bezeichnet. Kernstück des Schienengelen-

kes 4, das die beiden Schienen 2, 3 miteinander verbindet, ist ein (in den Figuren 4A und 4B näher dargestelltes) Gehäuse 12, das in einem randseitigen Bereich mit der ersten Schiene 2 fest verschraubt ist. Auf der in Figur 2 vorderen Seite des Gehäuses 12 ist ein Elastomerring 13, eine erste Anschlageneinstellscheibe 14 zum Einstellen des Extensionsanschlags, eine zweite Anschlageneinstellscheibe 15 zur Einstellung des Flexionsanschlags, eine Verriegelungsscheibe 16, welche die Anschlageneinstellscheiben 14, 15 umgibt, ein Elastomerring 17, ein (in Figur 5 näher dargestelltes) Drehteil 18 sowie eine Abdeckplatte 19 angeordnet.

Auf der in Figur 2 hinteren Seite des Gehäuses 12 ist ein zentraler Drehblock 20 zur Verstellung des Totpunktes des Federkraftmechanismus, ein im Drehblock 20 axial verschiebbar angeordneter Riegel 21, die zweite Schiene 3, auf der eine Anschlageneinrichtung 22 festgeschraubt ist, die erste Schiene 2 sowie eine Halteplatte 23 angeordnet.

An der zweiten Schiene 3 ist das Federgehäuse 7 festgeschraubt, in der sich die Druckfeder 24 befindet. Die Druckfeder 24 liegt mit ihrem vorderen Ende an einem Druckzylinder 25 an, der gelenkig mit der Druckstange 8 verbunden ist. Am gegenüberliegenden Ende ist die Druckstange 8 gelenkig mit einem radial vorragenden Arm 26 des zentralen Drehblocks 20 verbunden. Über die Druckstange 8 wird somit fortwährend die Schubkraft der Druckfeder 24 auf den Arm 26 übertragen.

Am hinteren Ende ist die Druckfeder 8 an einem Federspannkolben 27 abgestützt, der als Spindelmutter mit Innengewinde ausgebildet ist. In diesem Federspannkolben 27 ist

eine Federspannwelle 28 eingeschraubt, die eine Spindel darstellt. Diese Federspannwelle 28 kann über eine Klappkurbel 29, eine Kurbelwelle 30 und Getrieberäder 31 in Umdrehung versetzt werden, wodurch sich der Federspannkolben 27 in Axialrichtung bewegt, so dass die Vorspannkraft der Druckfeder 24 eingestellt werden kann. Die Getrieberäder 31 sind in einem Getriebegehäuse 32 gelagert.

Weiterhin ist in Figur 2 noch in Einzeldarstellung der Drehknopf 11 gezeigt, mit dem ein Exzenterteil 33 gedreht werden kann. Das Exzenterteil 33 dient, wie später noch näher erläutert wird, zum Verriegeln bzw. Freigeben eines radial angeordneten Arretierstifts 34, der im Arm 26 des Drehblocks 20 längsverschiebbar gelagert ist.

Im Folgenden werden nun die Einzelteile und deren Funktionsweise anhand der Figuren 3 bis 13 näher erläutert.

Das Gehäuse 12 ist in Figur 4A von der Vorderseite und in Figur 4B von der Rückseite her dargestellt. Das Gehäuse 12 weist eine ebene Mittelwand 35 auf, die durch einen kreisbogenförmigen Längsschlitz 36 durchbrochen ist. Der Längsschlitz 36 erstreckt sich über etwa 180°. Von der Mittelwand 35 erstreckt sich senkrecht eine durch regelmäßig über den Umfang verteilte Schlitz 37 unterbrochene Umfangswand 38 nach oben, die damit einzelne Finger bildet. Die Breite der Schlitz 37 entspricht in etwa der Breite der Finger. Weiterhin steht über die Mittelwand 35 ein zentraler Hülsenabschnitt 39 vor, der als Drehlager für die in Figur 8 dargestellten Anschlageneinstellscheiben 14, 15 dient. Mittelwand 35 und Hülsenabschnitt 39 weisen eine durchgehende zentrale Bohrung 40 auf.

Über die Rückseite der Mittelwand 35 steht, wie aus Figur 4B ersichtlich, eine Umfangswand 41 vor. Die Höhe der Umfangswand 41 ist in einem ersten Umfangsabschnitt 42 höher als in einem zweiten Umfangsabschnitt 43. Im ersten
5 Umfangsabschnitt 42 befinden sich mehrere axial ausgerichtete Gewindebohrungen 44, um die erste Schiene 2, die auf dem ersten Umfangsabschnitt 42 aufliegt, mittels Schrauben 45 (Figur 3) festschrauben zu können. Die Höhe des zweiten Umfangsabschnitts 43 ist über eine Umfangs-
10 länge von etwa 200° gegenüber dem ersten Umfangsabschnitt 42 reduziert, um einen entsprechenden Freiraum für die erste Schiene 2 und die Druckstange 8 zu schaffen, die sich radial über den zweiten Umfangsabschnitt 43 hinaus erstrecken. Im zweiten Umfangsabschnitt 43 sind weiterhin
15 eine Mehrzahl von in Umfangsrichtung regelmäßig beabstandeten radialen Arretierbohrungen 46 vorgesehen, in die der Arretierstift 34 des zentralen Drehblocks 20 eingeführt werden kann, wodurch die Drehposition des Drehblocks 20 relativ zum Gehäuse 12 arretiert wird. Die Drehposition
20 des Drehblocks 20 und damit diejenige des Anlenkpunktes 47 (Figur 2) der Druckstange 8 am Arm 26 kann somit dadurch eingestellt werden, dass der Drehblock 20 bei zurückgezogenem Arretierstift 34 zunächst bis zur gewünschten Drehposition gedreht wird, worauf der Arretierstift 34 in der
25 gewünschten Arretierbohrung 46 eingerastet wird. Dieser Vorgang wird nachfolgend noch näher beschrieben.

Wie aus Figur 3 ersichtlich, sitzt auf der ebenen Mittelwand 35 des Gehäuses 12 der erste Elastomerring 13, der
30 den zentralen Hülsenabschnitt 39 eng umgibt. Auf dem ersten Elastomerring 13 sitzt die erste Anschlageneinstellscheibe 14 und darauf die zweite Anschlageneinstellscheibe 15 sowie der Elastomerring 17.

Diese AnschlagEinstellscheiben 14, 15 sind weitgehend identisch ausgebildet, so dass in Figur 8 nur eine dieser AnschlagEinstellscheiben 14, 15 dargestellt ist. Die AnschlagEinstellscheiben 14, 15 sind kreisförmig und weisen eine mittige Durchgangsöffnung 49 auf, so dass sie mit geringem Spiel auf den zentralen Hülsenabschnitt 39 des Gehäuses 12 aufgesteckt werden können. Der zentrale Hülsenabschnitt 39 bildet somit ein Drehlager für die AnschlagEinstellscheiben 14, 15. Weiterhin können sich die AnschlagEinstellscheiben 14, 15 auch noch geringfügig axial bewegen, soweit es die Elastomerringe 13, 17 erlauben, zwischen denen sie eingespannt sind und die aus relativ weichem Material bestehen.

An ihrem Außenumfang weisen die AnschlagEinstellscheiben 14, 15 eine relativ feine Außenverzahnung 50 auf, die in Figur 8 schematisch dargestellt ist. Zwischen dem Außenumfang und der Durchgangsöffnung 49 erstreckt sich ein durchgehender, kreisbogenförmiger Längsschlitz 51 über einen Winkelbereich von etwa 200°. Die beiden AnschlagEinstellscheiben 14, 15 werden so montiert, dass die beiden Längsschlitze 51 zumindest zum überwiegenden Teil zur Deckung gebracht werden können und diese wiederum über dem Schlitz 36 des Gehäuses 12 liegen. Auf diese Weise kann ein in Figur 3 dargestellter Anschlagstift 52, der über ein Sockelteil 53 und Schrauben 54 fest mit der zweiten Schiene 3 verbunden ist, sich von unten her durch die Längsschlitze 36, 51 nach oben erstrecken und sich längs dieser bewegen. Da die AnschlagEinstellscheiben 14, 15 über die Außenverzahnungen 50 drehfest relativ zum Gehäuse 12 und damit zur ersten Schiene 2 arretiert sind, kann sich der Anschlagstift 52 soweit innerhalb der Längsschlitze 36, 51 bewegen, bis er am Ende der Längsschlitze

51 angelangt ist und entweder am Anschlag 55 oder am gegenüberliegenden Anschlag 56 anschlägt. Es ist somit erkennbar, dass die Position der Schwenkbereichsgrenzen von der Position der Anschläge 55, 56 relativ zum Gehäuse 12 und damit zur ersten Schiene 2 abhängt und dass durch unabhängiges Drehen der Anschlageneinstellscheiben 14, 15 relativ zum Gehäuse 12 die Schwenkbereichsgrenzen in Flexions- und Extensionsrichtung unabhängig voneinander eingestellt werden können.

10

Um nach einer nachfolgend noch näher beschriebenen Entriegelung der Anschlageneinstellscheiben 14, 15 diese in die gewünschte Drehposition drehen zu können, weist jede Anschlageneinstellscheibe 14, 15, wie auch aus Figur 3 ersichtlich, einen Einstellstift 57, 58 auf, der nach oben durch einen kreisbogenförmigen Längsschlitz 59 der Abdeckplatte 19 (Figur 6) hindurchragt und über die Abdeckplatte 19 nach oben etwas vorsteht, so dass die Einstellstifte 57, 58 mit den Fingern bewegt werden können. Entlang dieses Längsschlitzes 59 ist eine entsprechende Grad-einteilung 60 auf der Abdeckplatte 19 aufgebracht, um die Position der Anschläge 55, 56 und damit die Schwenkbereichsgrenzen in Flexions- und Extensionsrichtung ablesen zu können.

25

Die Verriegelung der Anschlageneinstellscheiben 14, 15 in der gewünschten Drehposition erfolgt über die Verriegelungsscheibe 16, die in den Figuren 7A und 7B näher dargestellt ist. Die Verriegelungsscheibe 16 ist ringförmig ausgebildet und weist einen lichten Innendurchmesser auf, der dem Außendurchmesser der Anschlageneinstellscheiben 14, 15 entspricht. An der inneren Umfangswand trägt die Verriegelungsscheibe 16 eine Innenverzahnung 61, die mit der

30

Außenverzahnung 50 der Anschlageneinstellscheiben 14, 15 in Eingriff gebracht werden kann. Weiterhin weist die Verriegelungsscheibe 16 regelmäßig über ihren Außenumfang verteilte Radialvorsprünge 62 auf, deren Länge (in Umfangsrichtung) der Breite der Schlitze 37 in der Umfangswand 38 des Gehäuses 12 entsprechen. Ist die Verriegelungsscheibe 16 im Gehäuse 12 eingesetzt, erstrecken sich die Radialvorsprünge 62 durch die Schlitze 37 des Gehäuses 12 hindurch, so dass die Verriegelungsscheibe drehfest, jedoch axial verschiebbar, im Gehäuse 12 aufgenommen ist. Der Außendurchmesser der Radialvorsprünge 62 ist weiterhin etwas größer als der Außendurchmesser der Umfangswand 38 des Gehäuses 12, so dass die Radialvorsprünge 62 geringfügig radial nach außen über die Umfangswand 38 hinausstehen.

Die Verriegelungsscheibe 16 kann mittels des Drehteils 18 axial relativ zum Gehäuse 12 verschoben werden. Hierzu weisen die Radialvorsprünge 62 ein äußeres Gewinde 63 auf, das mit einem Innengewinde 64 (Figur 5) des Drehteils 18 in Eingriff ist. Das im Wesentlichen hülsenförmig ausgebildete Drehteil 18 bildet den radialen Außenmantel des Schienengelenkes 4, das den oberen Teil des Gehäuses 12 einschließlich der Umfangswand 41, in dem sich die Arretierungsbohrungen 46 befinden, überdeckt. Das Drehteil 18 ist axial unverschiebbar, jedoch drehbar am Gehäuse 12 festgelegt. Hierzu weist das Drehteil 18 in seinem unteren Drittel eine radial nach innen vorspringende Schulter 65 auf, die auf einem randseitigen Absatz 66 des Gehäuses 12 aufliegt (Figur 3) und das Drehteil 18 axial nach unten festgelegt. Eine Axialverschiebung des Drehteils 18 nach oben wird durch eine radial nach innen vorspringende Schulter 67 verhindert, die sich am oberen Ende des Drehteils 18 befindet und vom Rand der Abdeckplatte 19 über-

griffen wird.

Wie aus Figur 3 weiter ersichtlich, ist zwischen der ebenen Mittelwand 35 und der ersten Anschlageneinstellscheibe 14 aufgrund des dazwischen liegenden Elastomerrings 13 ein axialer Freiraum 68 vorhanden. In gleicher Weise befindet sich zwischen der zweiten Anschlageneinstellscheibe 15 und der Abdeckplatte 19 aufgrund des dazwischen liegenden Elastomerrings 17 ein axialer Freiraum 69. Die Höhe der Freiräume 68, 69 ist etwas größer als die Dicke der Anschlageneinstellscheibe 14 bzw. 15. Die Elastomerringe 13, 17 halten, da sie die gleiche Höhe haben, die Anschlageneinstellscheiben 14, 15 - in Axialrichtung gesehen - in der Mitte zwischen der Mittelwand 35 und der Abdeckplatte 19.

Die Verriegelungsscheibe 16 bildet zusammen mit dem Drehteil 18 eine Feststelleinrichtung zum Lösen und Arretieren der Anschlageneinstellscheiben 14, 15.

Die Verriegelungsscheibe 16, welche dieselbe Dicke hat wie die beiden Anschlageneinstellscheiben 14, 15 zusammengenommen, kann durch Drehen des Drehteils 18 spindelartig nach oben oder unten verfahren werden, wie anhand der Figuren 12A bis 12C gezeigt. In Figur 12A befindet sich die Verriegelungsscheibe 16 auf gleicher Höhe wie die beiden Anschlageneinstellscheiben 14, 15. Beide Anschlageneinstellscheiben 14, 15 sind daher mit der Innenverzahnung 61 der Verriegelungsscheibe 16 in Eingriff und durch diese drehfest arretiert. Wird das Drehteil 18 in einer bestimmten Richtung gedreht, kann die Verriegelungsscheibe 16 soweit nach oben verschoben werden, bis die untere Anschlageneinstellscheibe 14 außer Eingriff mit der Verriegelungsscheibe 16 ist. Dieser Zustand ist in Figur 12B gezeigt. Die

untere Anschlageneinstellscheibe 14 kann daher von Hand mittels des Einstellstifts 57 in die gewünschte Drehposition gebracht werden, um beispielsweise den Extensionsanschlag einzustellen. Wird anschließend der Drehring 18 in die entgegengesetzte Richtung gedreht, kann die Verriegelungsscheibe 16 soweit nach unten bewegt werden, bis die obere Anschlageneinstellscheibe 15 außer Eingriff mit der Verriegelungsscheibe 16 ist. Dieser Zustand ist in Figur 12C dargestellt. Die obere Anschlageneinstellscheibe 15 kann nun mittels des Einstellstifts 58 in die gewünschte Stellung gedreht werden, um beispielsweise den Flexionsanschlag einzustellen. Sind beide Anschlageneinstellscheiben 14, 15 richtig eingestellt, wird das Drehteil 18 wieder zurückgeschraubt, bis die Verriegelungsscheibe 16 beide Anschlageneinstellscheiben 14, 15 verriegelt (Figur 12A).

Da es vorkommen kann, dass bei der Axialbewegung der Verriegelungsscheibe 16 von der in den Figuren 12B oder 12C gezeigten Position in die mittlere, in Figur 12A gezeigte Position die Innenverzahnung 61 der Verriegelungsscheibe 16 nicht gleich mit der Außenverzahnung 50 der Anschlageneinstellscheiben 14, 15 kämmt, sondern Gewindegänge auf Gewindegänge stoßen, sind die Elastomerringe 13, 17 relativ weich ausgebildet und ermöglichen ein Nachgeben der Anschlageneinstellscheiben 14, 15 in axialer Richtung. Hierdurch wird das Inneinandergreifen der Verzahnungen erleichtert.

In Figur 6 ist die Abdeckplatte 19 dargestellt. Wie ersichtlich, sind auf der Oberseite die Hinweise "Einstellung Flexion", "Stop" und "Einstellung Extension" angebracht. Diese Hinweise geben an, in welche Richtung das Drehteil 18 gedreht werden muss, um die Anschlageneinstell-

scheibe für den Flexionsanschlag bzw. diejenige für den Extensionsanschlag frei zu geben. In der Position "Stop" sind beide Anschlageneinstellscheiben 14, 15 verriegelt.

5 Anhand der Figuren 9 bis 11 wird nachfolgend der Totpunkt-
verstellmechanismus näher beschrieben, mit dem der Tot-
punkt verstellt werden kann, ab dem die Wirkrichtung des
Federkraftmechanismus von Flexion auf Extension bzw. umge-
kehrt umschaltet. Der zentrale Drehblock 20, der in Figur
10 11 in Einzeldarstellung gezeigt ist, weist hierzu einen
zylindrischen Abschnitt 70 auf, der in die mittige Bohrung
40 des Gehäuses 12 eingesetzt und darin drehbar gelagert
ist. An den zylindrischen Abschnitt 70 schließt sich ein
zylindrischer Abschnitt 72 größeren Durchmessers an, an
15 dem der Arm 26 derart angeformt ist, dass er sich radial
vom Abschnitt 72 weg erstreckt. An den zylindrischen Ab-
schnitt 72 schließt sich ein umlaufender Radialvorsprung
73 an. Dieser Radialvorsprung 73 dient als Anlagefläche
für den kreisförmigen Endabschnitt 74 der zweiten Schiene
20 3. An den Radialvorsprung 73 schließt sich ein zylindri-
scher Abschnitt 75 an (Figur 11), der als Radiallager für
die zweite Schiene 3 dient. Im zylindrischen Abschnitt 75
sind axiale Gewindebohrungen 76 vorgesehen, um die Halte-
platte 23 mittels in Figur 3 angedeuteter Schrauben 77
25 festschrauben zu können.

Wie aus den Figuren 9 und 10 ersichtlich, befindet sich im
zylindrischen Abschnitt 70 des Drehblocks 20 eine mittige
axiale Bohrung 78, in dem ein Zylinderabschnitt 79 des
30 Exzenterteils 33 drehbar gelagert ist. Die Bohrung 78
mündet in eine kreisförmige Tasche 80 größeren Durchmes-
sers, die bezüglich der Bohrung 78 exzentrisch angeordnet
ist. Die Tasche 80 dient zur Aufnahme eines exzentrischen

Zylinderabschnitts 81 des Exzenterteils 33, so dass sich dieses nicht drehen kann, wenn der exzentrische Zylinderabschnitt 81 in der Tasche 80 liegt. Diese Position ist in Figur 10 dargestellt.

5

An die Tasche 80 schließt sich eine axiale, mittige Bohrung 82 größeren Durchmessers an. Der Durchmesser dieser Bohrung 82 ist derart bemessen, dass das Exzenterteil 33 beliebig gedreht werden kann, wenn es aus der in Figur 10 gezeigten Stellung in axialer Richtung, d.h. in Richtung des Pfeils 91, so weit nach oben verschoben worden ist, dass sich der exzentrische Zylinderabschnitt 81 oberhalb der Tasche 80 befindet.

15

Wie aus Figur 9 ersichtlich, erstreckt sich unmittelbar oberhalb der Tasche 80 eine radiale Bohrung 83 durch den gesamten Arm 26 hindurch, die zur Aufnahme des Arretierstifts 34 und einer Druckfeder 84 dient (Figur 10). Die Bohrung 83 weist in einem äußeren Endabschnitt 85 einen geringeren Durchmesser auf, so dass eine Schulter 86 gebildet wird, an der sich das äußere Ende der Druckfeder 84 abstützt. Der Arretierstift 34 weist einen Schaft 87 und einen Kopf 88 größeren Durchmessers auf, an dem das gegenüberliegende Ende der Druckfeder 84 abgestützt ist. Die Länge des Arretierstifts 34 ist weiterhin derart bemessen, dass sein äußeres Ende über den Arm 26 hinaus und in eine der Arretierbohrungen 46 hinein ragt, wenn das gegenüberliegende Ende des Kopfes 88 bündig mit der Wand der Bohrung 82 abschließt. Befindet sich in diesem Zustand, der in Figur 10 gezeigt ist, der exzentrische Zylinderabschnitt 81 des Exzenterteils 33 innerhalb der Tasche 80, kann sich der Arretierstift 34 nicht in die Bohrung 82 zurück bewegen, da er am exzentrischen Zylinderabschnitt

30

81 anstößt. Der Arretierstift 34 ist damit in einer eine Drehbewegung des Drehblocks 20 relativ zum Gehäuse 12verhindernden Weise verriegelt. Der Anlenkpunkt 47 (Figur 2) der durch eine axiale Bohrung 89 im Arm 26 (Figur 10) und
5 durch einen in der Druckstange 8 befestigten und in die Bohrung 89 eingreifenden Gelenkstift 90 (Figur 3) gebildet wird, ist damit relativ zum Gehäuse 12 festgelegt.

Um den Anlenkpunkt 47 und damit den Totpunkt des Federkraftmechanismus zu verstellen, wird das Exzenterteil 33
10 in Richtung des Pfeils 91 (Figur 10) entgegen der Kraft einer Druckfeder 92 (Figur 3) mittels des Drehknopfs 11 verschoben, bis der exzentrische Zylinderabschnitt (81) außerhalb der Tasche 80 liegt. Das Exzenterteil 33 kann
15 anschließend mittels des Drehknopfs 11, der über einen Vierkant 93 drehfest mit dem Exzenterteil 33 verbunden ist, um 180° gedreht werden, wodurch sich der Arretierstift 34 unter der Druckkraft der Druckfeder 84 in die Bohrung 82 zurück bewegt und das gegenüberliegende Ende
20 des Arretierstifts 34 aus der Arretierbohrung 36 austreten kann. Der Drehblock 20 kann nun bis zu einer anderen gewünschten Arretierbohrung 46 weiter gedreht werden, worauf der Arretierstift 34 durch Zurückdrehen des Exzenterteils 33 wieder in die verriegelnde Eingriffsposition gebracht
25 wird.

Die Drehung des Drehteils 20 in die gewünschte Position relativ zum Gehäuse 12 erfolgt bei entriegeltem Arretierstift 33 mittels der zweiten Schiene 3, die über den in
30 den Figuren 2 und 3 dargestellten Riegel 21 drehfest mit dem Drehblock 20 verbunden werden kann. Der Riegel 21 weist ein napfförmiges Mittelteil 94 auf, von dem aus sich zwei Flügel 95 nach entgegengesetzten Seiten erstrecken.

Im normalen Betrieb der Orthese, d.h. wenn sich in Figur 10 das Exzenterteil 33 in der dargestellten tiefsten Stellung befindet, ist das napfförmige Mittelteil 94 des Riegels 21 in der tiefstmöglichen Position innerhalb der Bohrung 82 angeordnet, wobei die Flügel 95 tief in Radialnuten 96 des zentralen Drehblocks 20 (Figur 11) liegen. In diesem Zustand stehen die Flügel 95 nach oben nicht über den Radialvorsprung 73 vor, so dass sich die zweite Schiene 3 um den zylindrischen Abschnitt 75 des Drehblocks 20 drehen kann. Wird jedoch zum Entriegeln des Arretierstifts 34 das Exzenterteil 33 nach oben geschoben (s. Pfeil 91 in Figur 10), wird hierdurch auch der Riegel 21 nach oben geschoben, wodurch die Flügel 95 axial in den Bereich des zylindrischen Abschnitts 75 und in seitliche Nuten 97 (Figur 13) hineingeschoben werden können, die sich von der zentralen Lagerbohrung 98 der zweiten Schiene 3 aus radial nach außen erstrecken. Hierdurch ist die zweite Schiene 3 drehfest mit dem Drehblock 20 gekoppelt, so dass dieser mittels der zweiten Schiene 3 in der gewünschten Weise verdreht werden kann, wenn der Arretierstift 34 entriegelt ist.

Das napfförmige Mittelteil 94 des Riegels 21 dient, wie aus Figur 3 ersichtlich, zum Abstützen der Druckfeder 92. Das gegenüberliegende Ende der Druckfeder 92 ist an der äußeren, mittigen Halteplatte 23 abgestützt. Wird das Exzenterteil 33 derart gedreht, dass der exzentrische Zylinderabschnitt 81 wieder in die Tasche 80 des Drehblocks 20 gelangen kann, drückt die Druckfeder 92 den Riegel 21 zusammen mit dem Exzenterteil 33 in die in Figur 3 dargestellte Position zurück. Dadurch gelangen die Flügel 95 des Riegels 21 außer Eingriff mit den seitlichen Nuten 97 der zweiten Schiene 3, so dass diese wieder in-

nerhalb der eingestellten Schwenkbereichsgrenzen um den Drehblock 20 und damit relativ zur ersten Schiene 2 geschwenkt werden kann.

5 Um die Reibung zwischen dem kreisförmigen Endteil der ersten Schiene 2 und dem kreisförmigen Endteil der zweiten Schiene 3 zu minimieren, ist zwischen diesen Endteilen, wie aus Figur 3 ersichtlich, eine Zwischenscheibe 99 eingesetzt.

10

In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Innengewinde 64 des Drehteils 18 (Figur 5) aus fertigungstechnischen Gründen auf einem separaten Gewinding 100 angebracht, der mittels eines geeigneten Klebers mit einem Mantel 101 des Drehteils 18 verbunden ist. Alternativ
15 hierzu ist es jedoch auch ohne weiteres möglich, das Innengewinde 64 direkt am Mantel 101 auszubilden.

Die Erfindung wurde anhand eines Beispiels einer Ellbogen-
20 orthese beschrieben, kann jedoch auch für andere Orthesen, beispielsweise Knieorthesen, Verwendung finden.

5

10

Patentansprüche:

1. Orthese mit
- 15 - einer ersten Schiene (2), die an einem ersten Körperglied befestigbar ist,
 - einer zweiten Schiene (3), die an einem zweiten Körperglied befestigbar ist,
 - einem Schienengelenk (4) zur schwenkbaren Verbindung der
 - 20 ersten und zweiten Schiene (2, 3),
 - mindestens einer um eine Schwenkachse (102) drehbare und in unterschiedlichen Drehpositionen arretierbaren Anschlag-einstellscheibe (14, 15) zur Einstellung einer Schwenkbereichsgrenze, und
 - 25 - einer Feststelleinrichtung zum Arretieren der Anschlag-einstellscheiben (14, 15),
- dadurch gekennzeichnet**, dass die Feststelleinrichtung eine in Richtung der Schwenkachse (102) verschiebbare, relativ zur ersten Schiene (2) drehfest angeordnete Verriegelungs-
- 30 scheibe (16) aufweist, welche durch Verschieben zwischen einer die Anschlag-einstellscheibe (14, 15) radial übergreifenden Arretierstellung, in der die Verriegelungs-scheibe (16) mit der Anschlag-einstellscheibe (14, 15) formschlüssig verriegelnd in Eingriff ist, und einer Frei-

gabestellung bewegbar ist, in welcher die Verriegelungsscheibe (16) außer Eingriff mit der Anschlageneinstellscheibe (14, 15) ist.

5 2. Orthese nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Anschlageneinstellscheibe (14, 15) eine Außenverzahnung (50) und die Verriegelungsscheibe (16) eine Innenverzahnung (61) aufweisen, die mit der Außenverzahnung (50) der Anschlageneinstellscheibe (14, 15) in und außer Kämmeingriff
10 bringbar ist.

15 3. Orthese nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verriegelungsscheibe (16) ein Gewinde (63) aufweist und über das Gewinde (63) spindelartig bewegbar ist.

20 4. Orthese nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verriegelungsscheibe (16) an ihrer radialen Außenumfangsfläche ein Gewinde (63) aufweist, und dass die Feststelleinrichtung ein die Verriegelungsscheibe (16) radial umgebendes, axial festgelegtes Drehteil (18) mit einem Innengewinde (64) aufweist, das mit dem Gewinde (63) der Verriegelungsscheibe (16) in Eingriff ist und durch Drehen eine axiale Verschiebung der Verriegelungsscheibe (16) bewirkt.

25 5. Orthese nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwei Anschlageneinstellscheiben (14, 15) zur Einstellung der Schwenkbereichsgrenzen in Extensions- und Flexionsrichtung vorgesehen sind, die
30 zueinander parallel und benachbart angeordnet und gleichzeitig durch die selbe Verriegelungsscheibe (16) arretierbar sind.

6. Orthese nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Feststelleinrichtung derart ausgebildet ist, dass durch Verschieben der Verriegelungsscheibe (16) in die eine Richtung die Extensions-Anschlageinstellscheibe (14) freigegeben wird und durch Verschieben der Verriegelungsscheibe (16) in die entgegengesetzte Richtung die Flexions-Anschlageinstellscheibe (15) freigegeben wird.

7. Orthese nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Schienengelenk (4) ein mit der ersten Schiene (2) fest verbundenes Gehäuse (12) mit einer die Verriegelungsscheibe (16) teilweise umgebenden Umfangswand (38) aufweist, dass die Verriegelungsscheibe (16) Radialvorsprünge (62) aufweist, und dass in der Umfangswand (38) Schlitze (37) vorgesehen sind, durch welche die Radialvorsprünge (62) hindurchgeführt sind, um ein Drehen der Verriegelungsscheibe (16) zu verhindern.

8. Orthese nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Gehäuse (12) einen zentralen Hülsenabschnitt (39) aufweist, der als Drehlager für die mindestens eine Anschlageinstellscheibe (14, 15) ausgebildet ist, dass ein Federkraftmechanismus vorgesehen ist, um die zweite Schiene (3) gegenüber der ersten Schiene (2) sowohl in Extensionsrichtung als auch in Flexionsrichtung vorzuspannen, und dass innerhalb des Hülsenabschnitts (39) eine Totpunktverstelleinrichtung für den Federkraftmechanismus drehbar gelagert ist.

9. Orthese nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Totpunktverstellmechanismus einen Drehblock (20) umfasst, in dem ein Arretierstift (34) quer zur Schwenkachse (102) verschiebbar geführt ist, dass das Gehäuse (12) eine

Mehrzahl von radialen Arretierbohrungen (46) aufweist, die in Umfangsrichtung des Gehäuses (12) beabstandet angeordnet sind, und dass innerhalb des Drehblocks (20) ein Exzenterteil (33) drehbar gelagert ist, um den Arretierstift (34) in Eingriff mit einer Arretierbohrung (46) zu halten
5 oder das Entfernen des Arretierstifts (34) aus der Arretierbohrung (46) zu ermöglichen.

10. Orthese nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass
10 der Drehblock (20) des Totpunktverstellmechanismus als Drehlager für die zweite Schiene (3) ausgebildet ist.


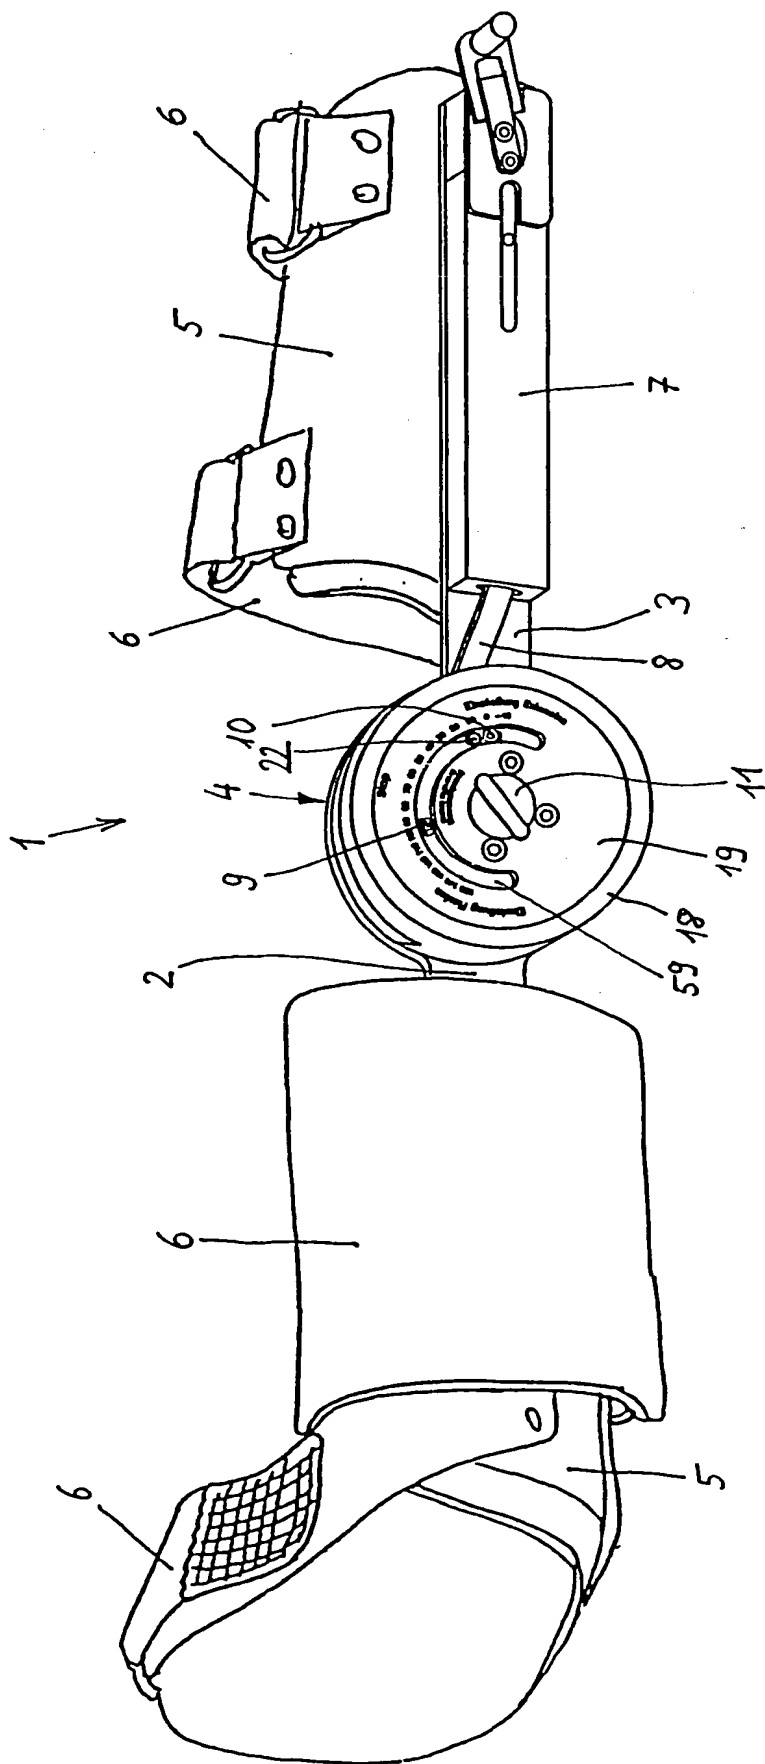


Fig. 1

DTOS Rec'd PCT/PTO 19 AUG 2004



DT09 rec'd PCT/PTO 19 AUG 2004

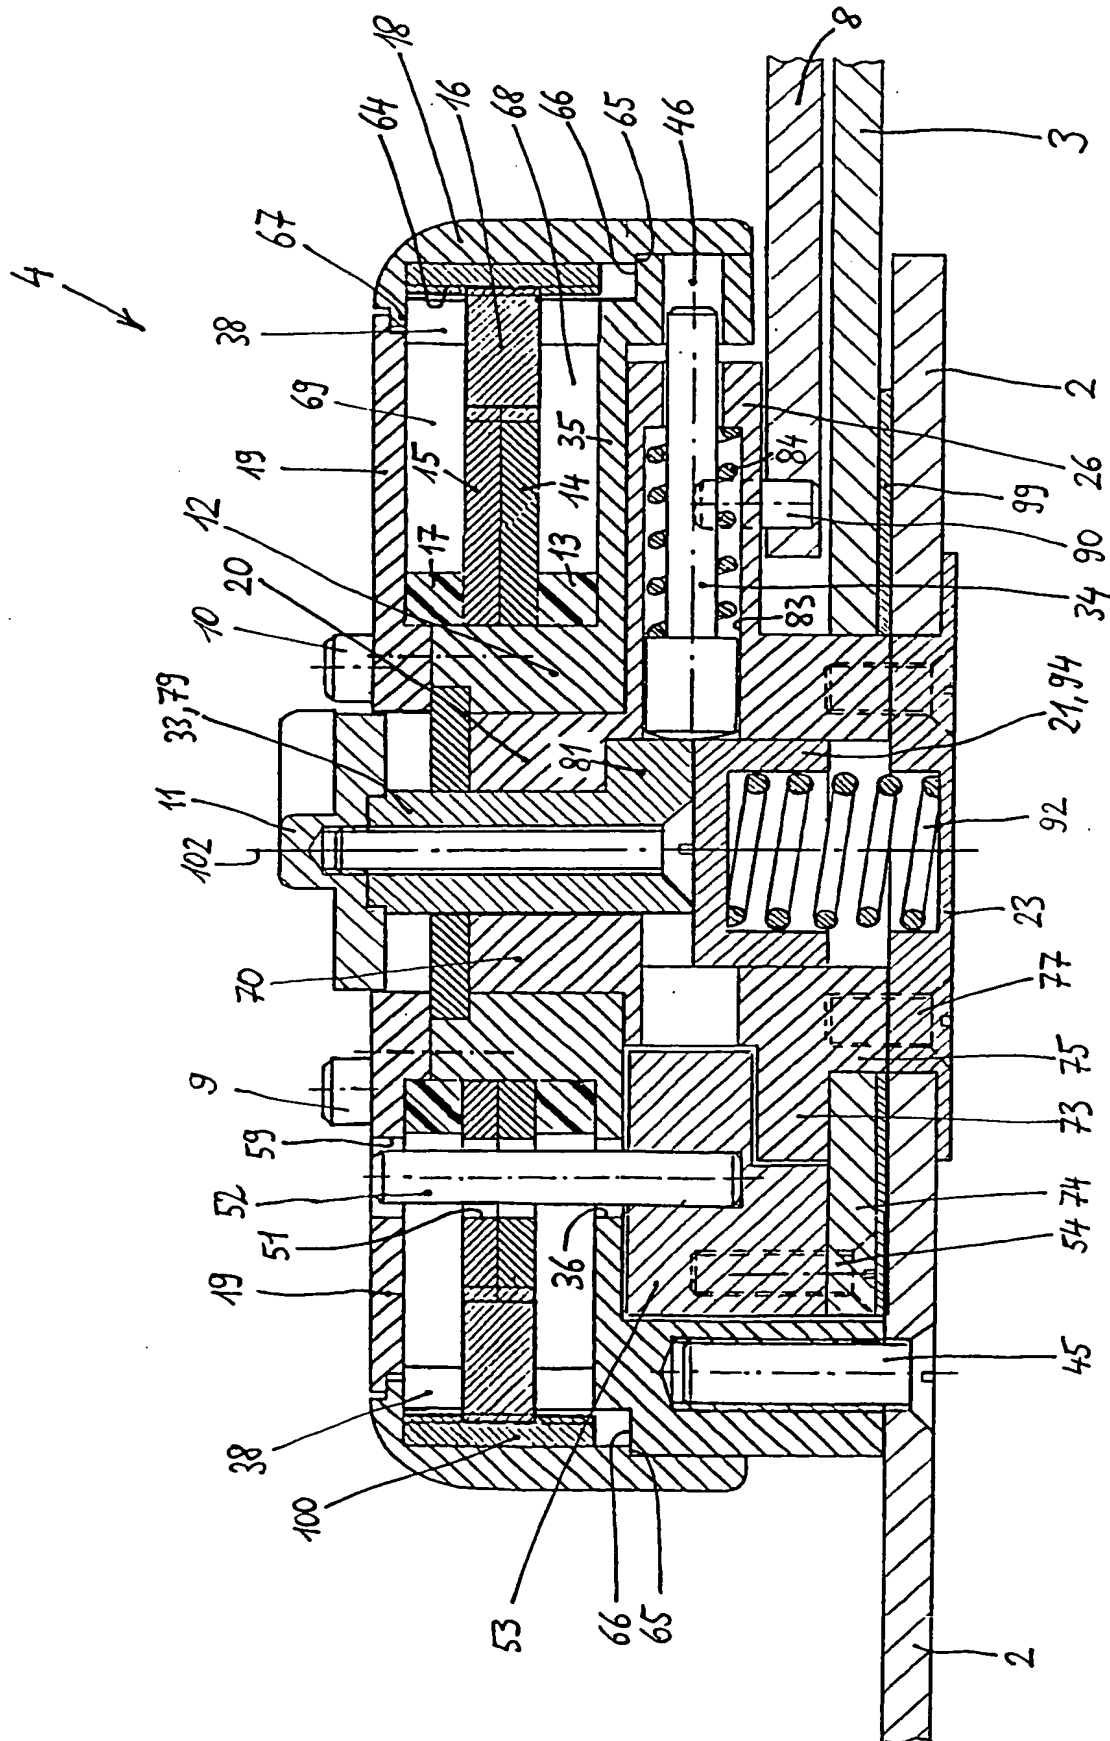


Fig. 3

DT09 [REDACTED] PCT/PTO 19 AUG 2004

4/7

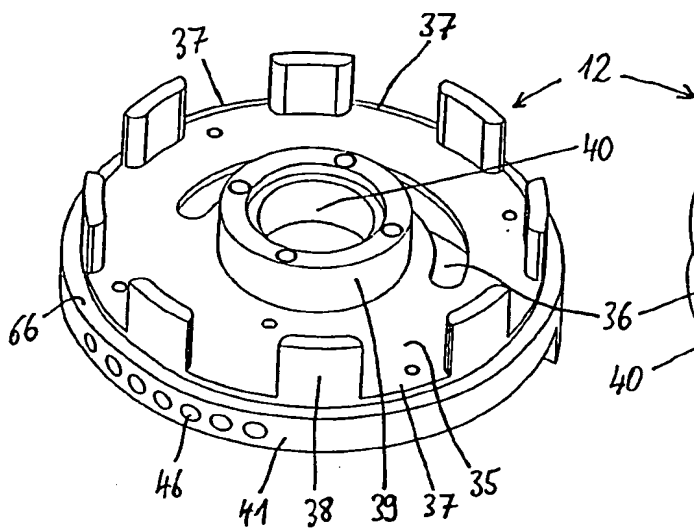


Fig. 4A

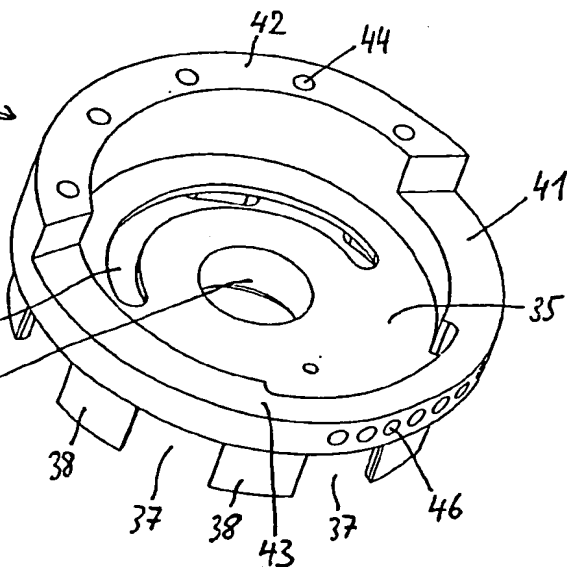


Fig. 4B

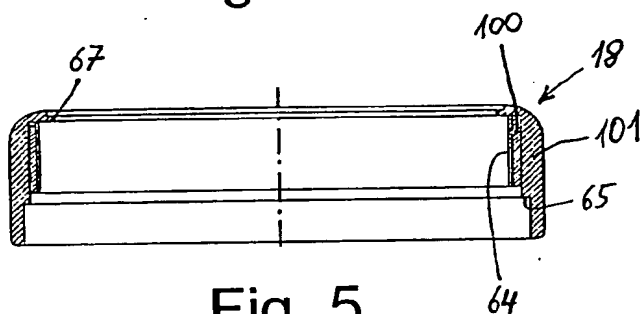


Fig. 5

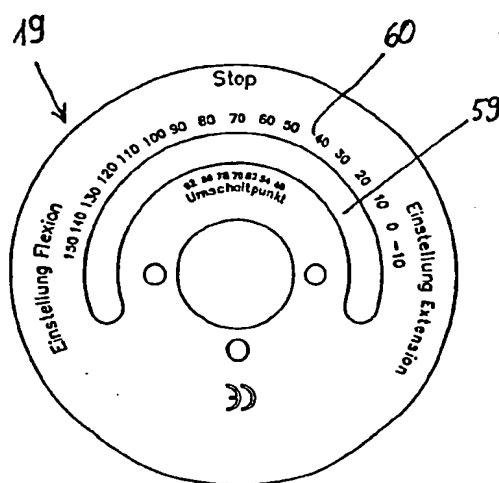


Fig. 6

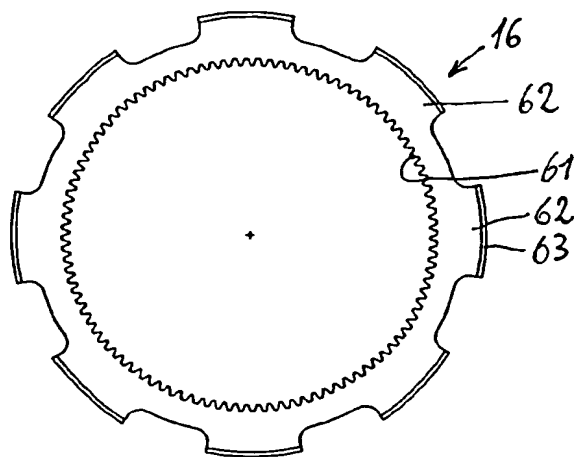


Fig. 7A

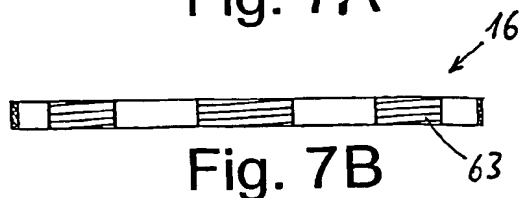


Fig. 7B

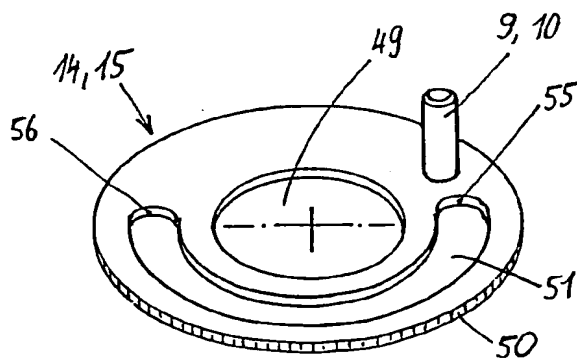


Fig. 8

DT09 REC'd PCT/PTO 19 AUG 2004

5/7

10/505359

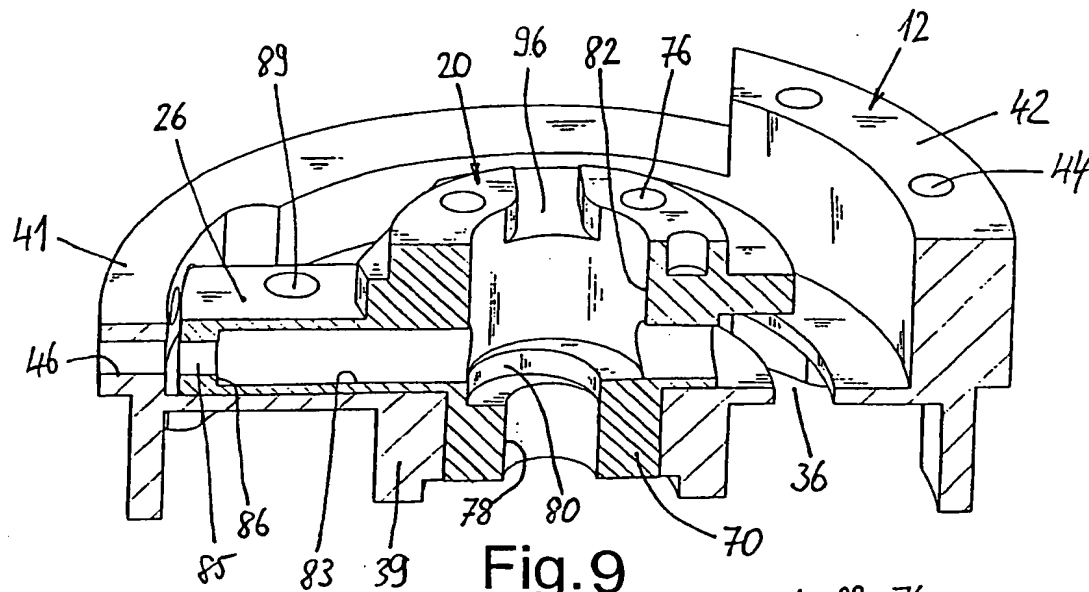


Fig. 9

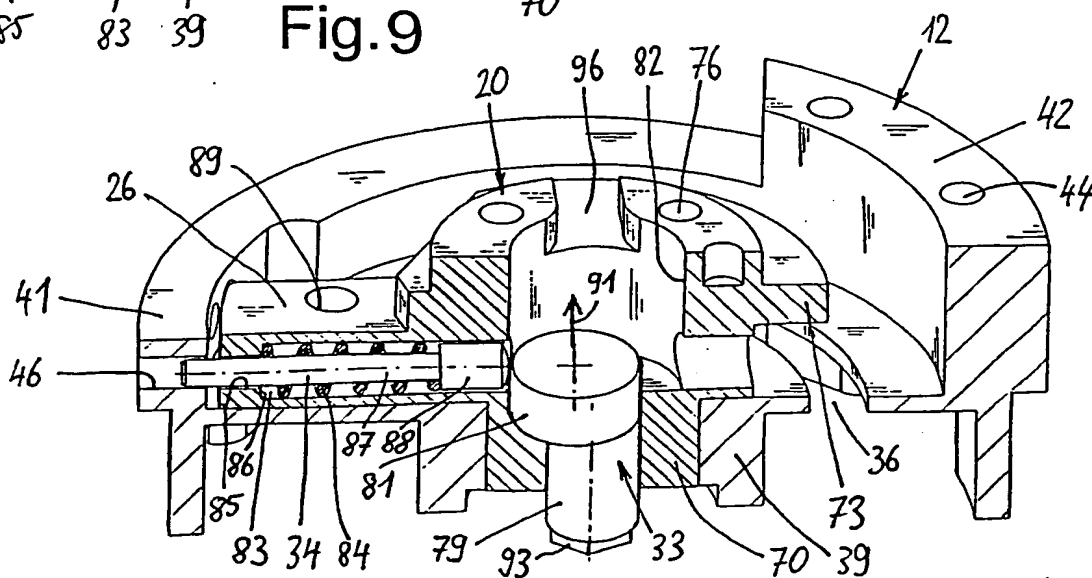


Fig. 10

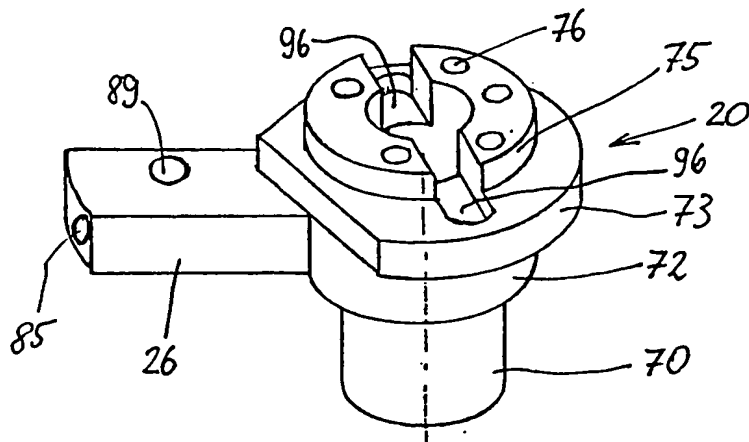


Fig. 11

DTOS [REDACTED] PCT/PTO 19 AUG 2004

6/7

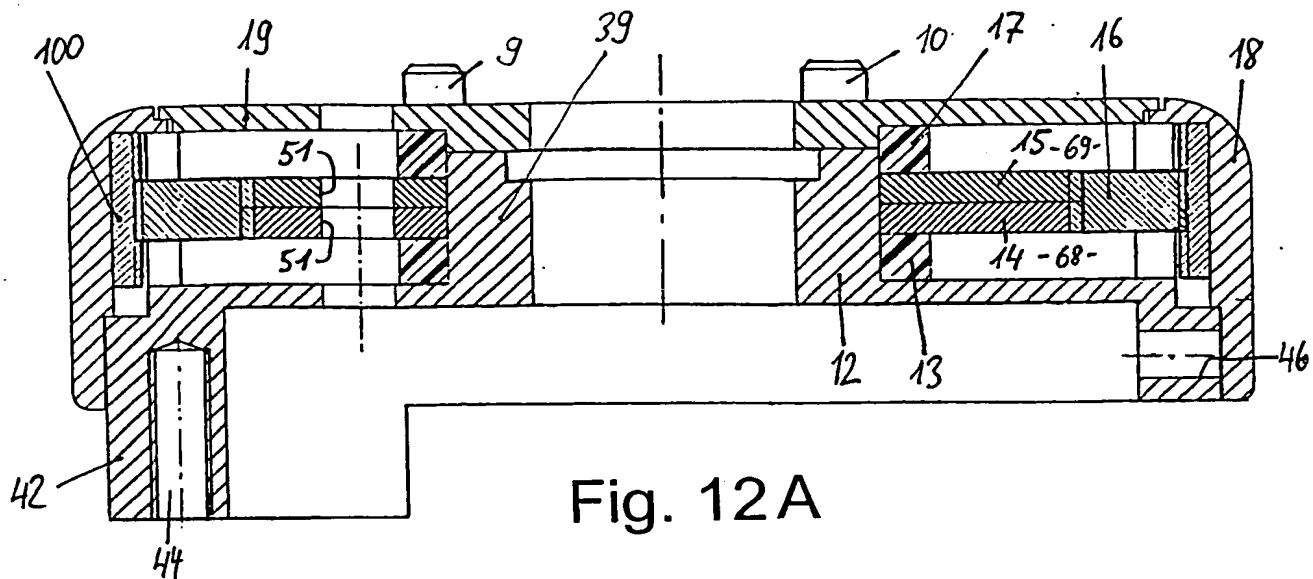


Fig. 12A

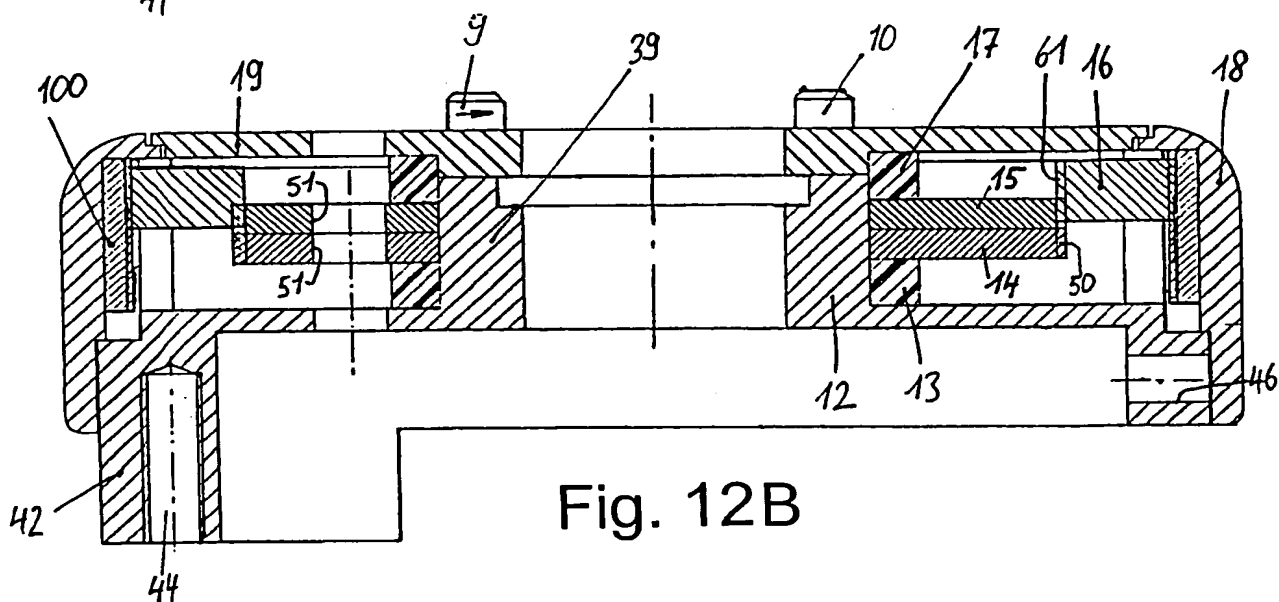


Fig. 12B

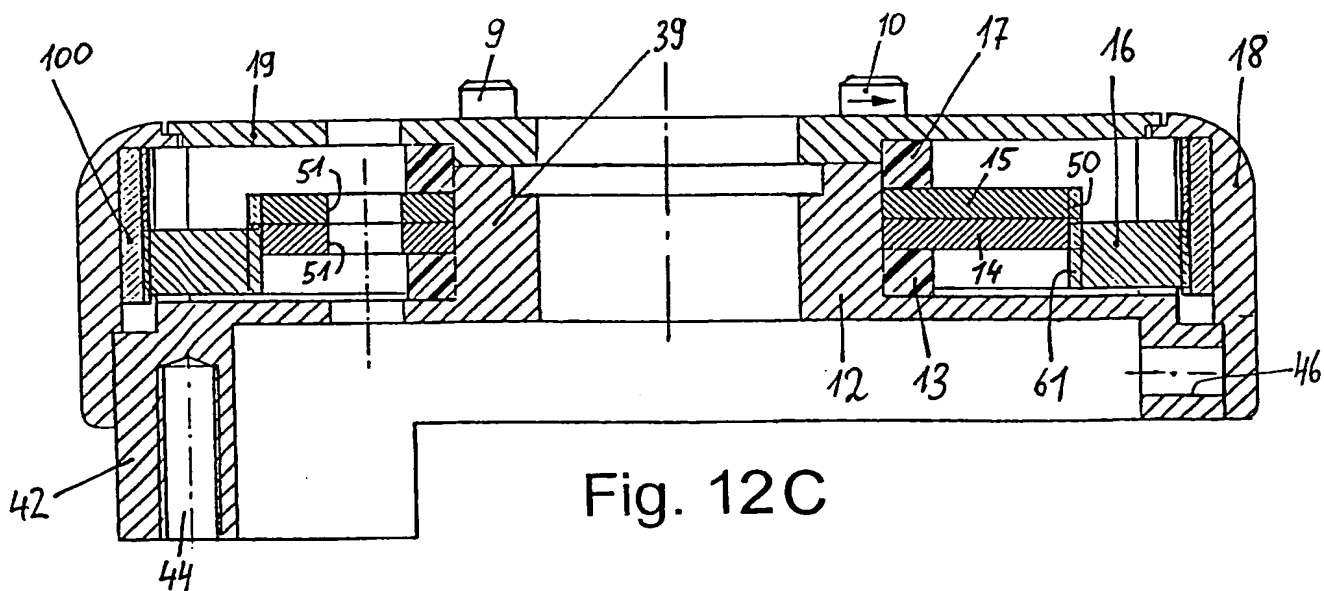


Fig. 12C

DTG [REDACTED] ec'd PCT/PTO 19 AUG 2004.

7/7

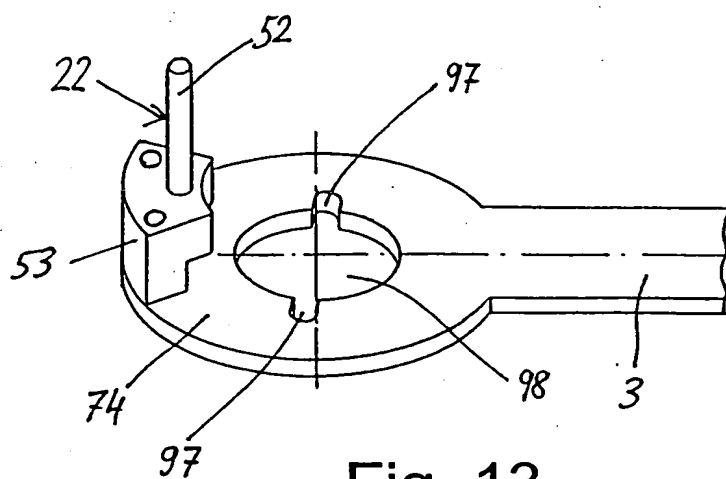


Fig. 13

DT09 Rec'd PCT/PTO 19 AUG 2004

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 03/01752

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 A61F5/01

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 203 511 B1 (JOHNSON JAMES A ET AL) 20 March 2001 (2001-03-20) column 3, line 52 -column 5, line 56; figures 1,3	1,2,5
A	DE 199 04 554 A (ALBRECHT GMBH) 31 August 2000 (2000-08-31) column 3, line 6 -column 5, line 16; figures 1,4,6	8-10
A	WO 01 58392 A (OPAHLE HANS GEORG ;ALBRECHT GMBH (DE); ALBRECHT ERICH (DE)) 16 August 2001 (2001-08-16) the whole document	8-10

☐

Further documents are listed in the continuation of box C.

☒

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 May 2003

Date of mailing of the international search report

02/06/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Lickel, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/01752

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6203511	B1	20-03-2001	NONE	
DE 19904554	A	31-08-2000	DE 19904554 A1	31-08-2000
WO 0158392	A	16-08-2001	DE 10005764 A1	20-09-2001
			WO 0158392 A1	16-08-2001
			EP 1253885 A1	06-11-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/01752

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A61F5/01

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 203 511 B1 (JOHNSON JAMES A ET AL) 20. März 2001 (2001-03-20) Spalte 3, Zeile 52 -Spalte 5, Zeile 56; Abbildungen 1,3	1,2,5
A	DE 199 04 554 A (ALBRECHT GMBH) 31. August 2000 (2000-08-31) Spalte 3, Zeile 6 -Spalte 5, Zeile 16; Abbildungen 1,4,6	8-10
A	WO 01 58392 A (OPAHLE HANS GEORG ;ALBRECHT GMBH (DE); ALBRECHT ERICH (DE)) 16. August 2001 (2001-08-16) das ganze Dokument	8-10

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

21. Mai 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

02/06/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Lickel, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/01752

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6203511	B1	20-03-2001	KEINE		
DE 19904554	A	31-08-2000	DE	19904554 A1	31-08-2000
WO 0158392	A	16-08-2001	DE	10005764 A1	20-09-2001
			WO	0158392 A1	16-08-2001
			EP	1253885 A1	06-11-2002